MegaPulse 1.2×50-7P 浪涌测试仪



描述：

MegaPlus 1.2x50-7P的波形严格按照标准EN60950，附录N，表N.1，第2行中数据处理设备的测试所设计。可用于Australian Deviation峰值不大于7kV的脉冲耐压测试。输出波形的容差完全满足IEC 1180的要求，电压范围1000—7000V，输出阻抗为38欧姆。按照附录N的要求，前面板仪表的读数为储能电容两端的开路电压（非输出电压）。

主要特点：

- 最大 7000V 测试电压
- 微控制器技术，前面板显示测试峰值开路电压以及极性
- 输出电压和极性由前面板手动控制
- 人体工学设计，安全，快速，有效
- 可选外部连锁，关闭高压输出
- 可选 USB 测试监护以及电脑控制
- 产品包括电缆，操作手册以及校准证书
- 一年校准周期，一年质保期

具体参数：

- 输出峰值电压 7kV: 6600V ±3%
- 开路上升时间: 1.24uS ±30% [Trise=1.67(T90%-T30%)] per IEC 1180
- 真实阻抗: 38 ohms
- 开路持续时间: 56.8uS ±20% (半值时间) per IEC 1180
- 电流波形: 未定义
- 电压控制: 手动，旋转前面板按钮
- 极性控制: 正极和负极，由可选电脑操控交替控制
- 电压显示 4 数码 LED 显示
- 电压计精确度: ±30V
- 充电时间: <5 s
- 线性电压: 120V AC, 50/60Hz *可选不同线性电压
- 操作温度：15℃～40℃
- 相对湿度：0～90% 无通风
- 尺寸：17”×3U×17”（W×H×D），6U x 17”x 17”(IEC 开关)
- 重量：约 30 磅


选件

- IER： IEC 65 图 7b 开关（6U 机箱)
- TMM： TestMinder 允许电脑使用计算机时钟进行计时并通过 PC 控制运行
- 220,230 或 240：如果使用不同的线路电压需要，使用此选项，我们安装一个降压变压器，使其与线路电压兼容。240： 240V 电源运行。230： 230V 电源运行。220： 220V 电源运行
- BNCV： 1000：1 衰减 BNC 端口（仅用于电压监视）

北京世纪汇泽科技有限公司

Century Wisdom
世纪汇泽

更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧

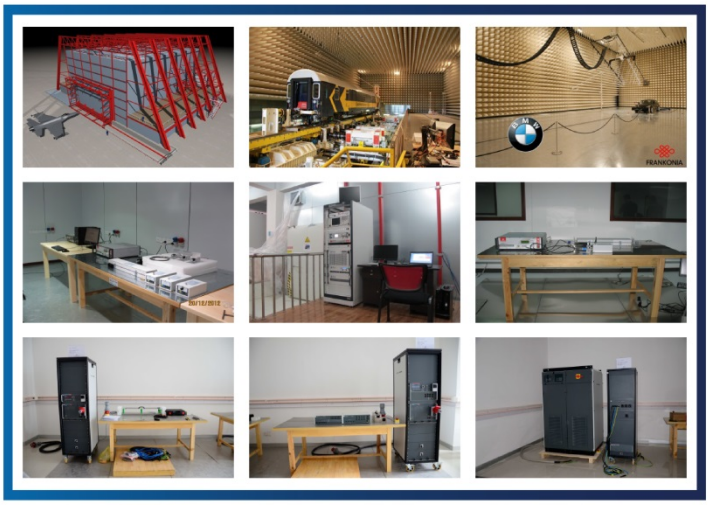

联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司
Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org
地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室
北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995
南京: +86 25 84528286
上海: +86 21 52911287
成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org
苏州实验室: www.emctest.org.cn